



操作パネル

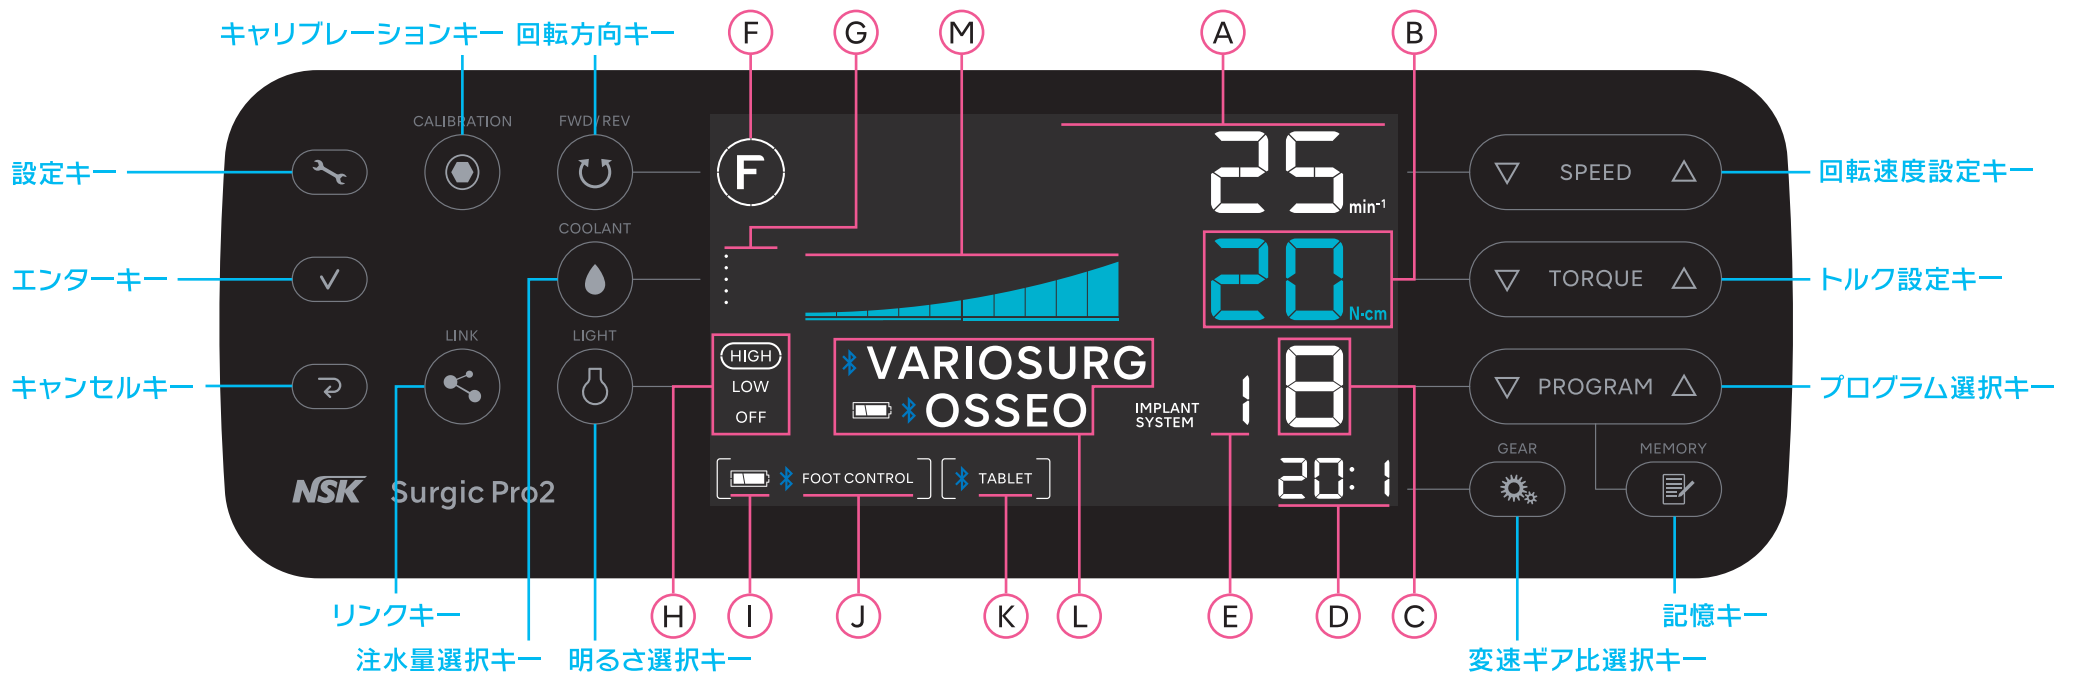


フットコントロール

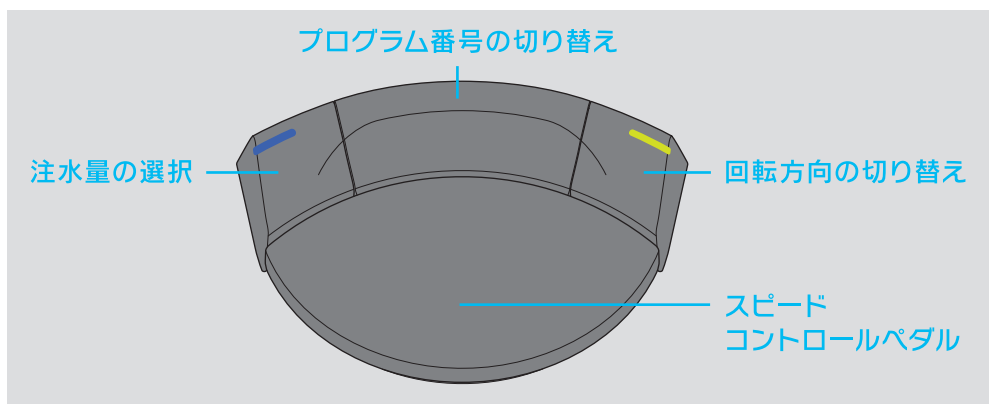


A	回転速度	H	ライトの明るさ
B	トルク上限値	I	フットコントロールの電池残量
C	プログラム番号	J	フットコントロールの接続状態
D	変速ギア比	K	外部端末との接続状態
E	インプラントシステム	L	VarioSurg 3、Osseo 100+との接続状態
F	回転方向	M	出力されているトルク
G	注水量		


使用前の準備

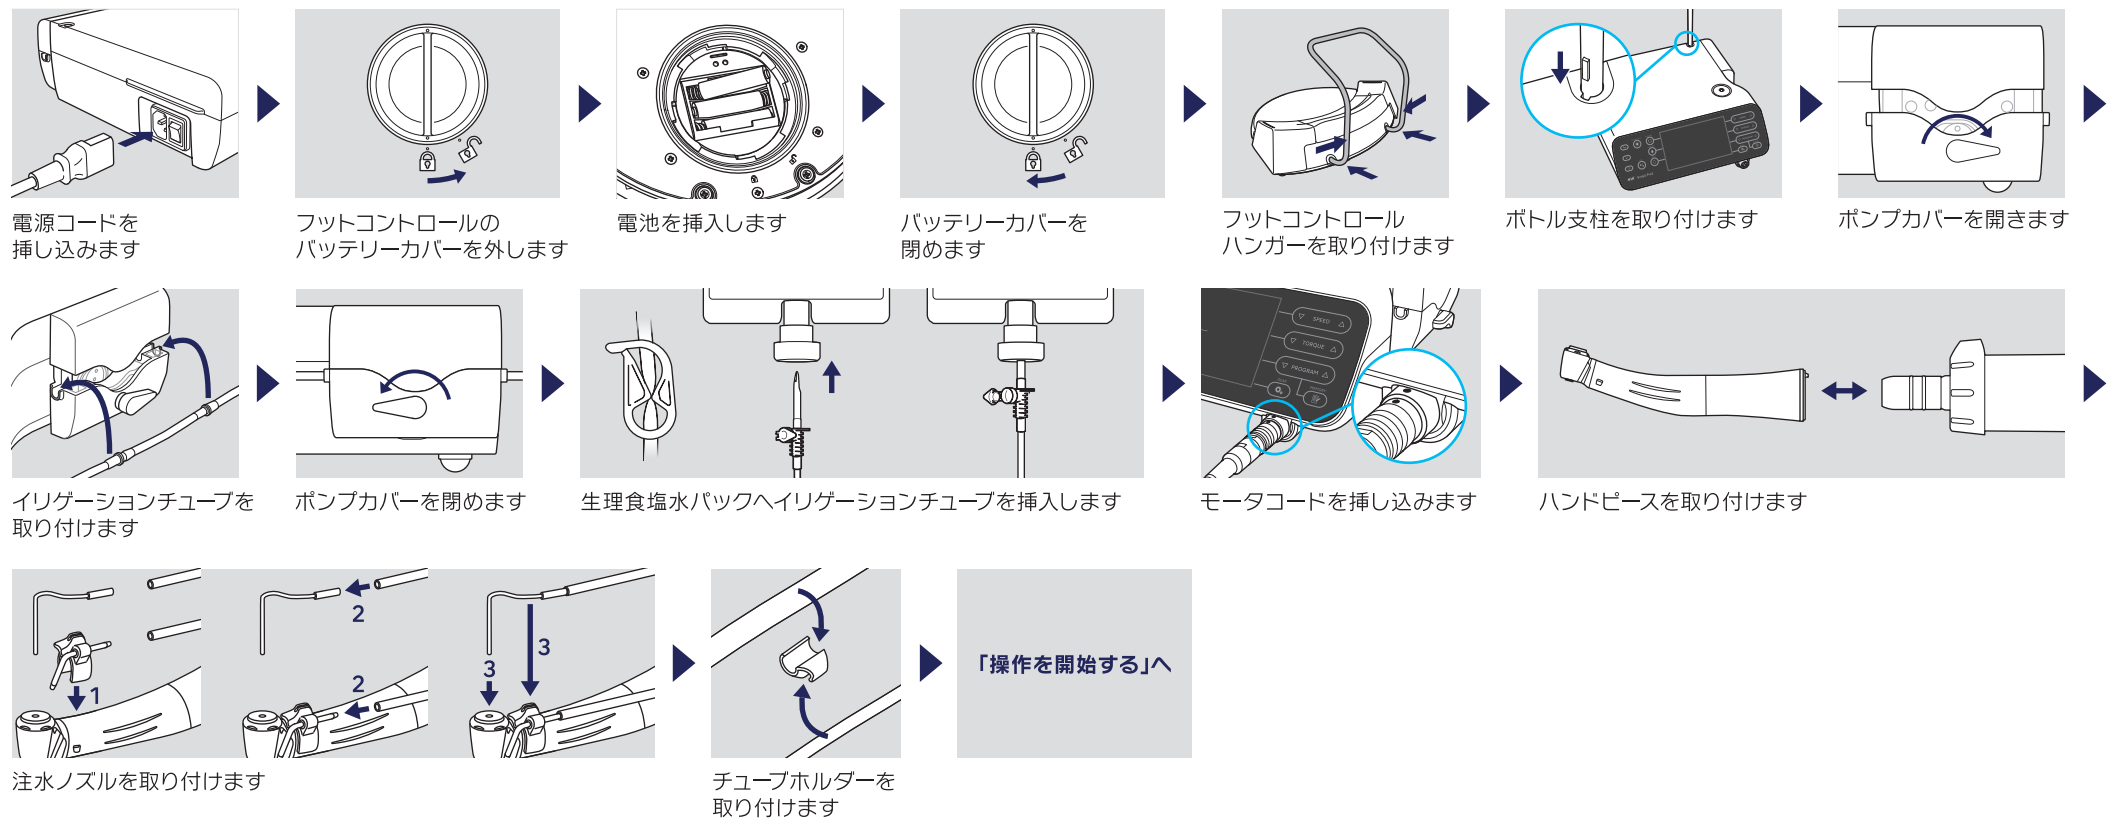


操作を開始する

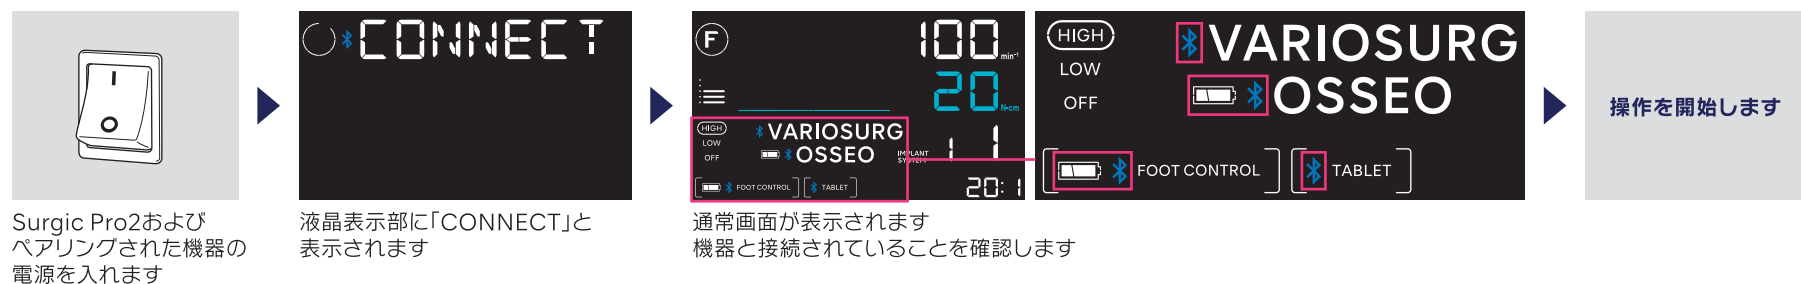

初めて使用するとき(機器のペアリング)

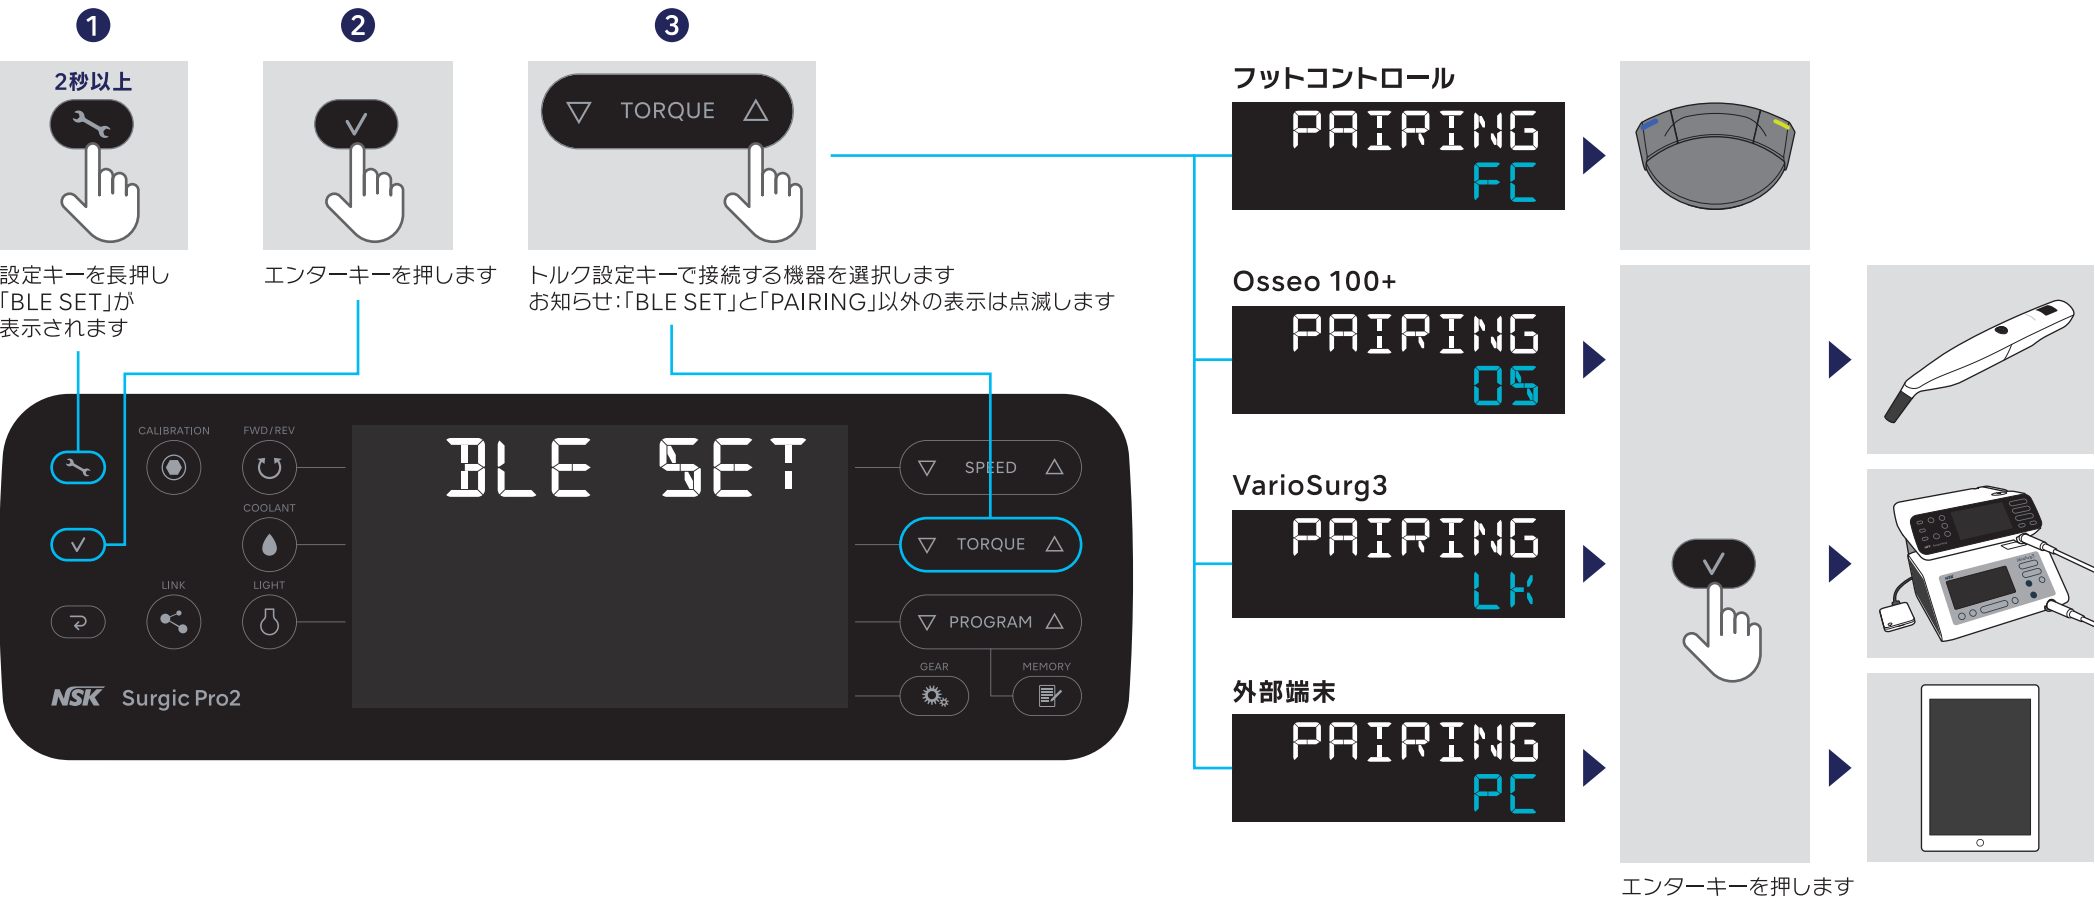

▼ フットコントロール

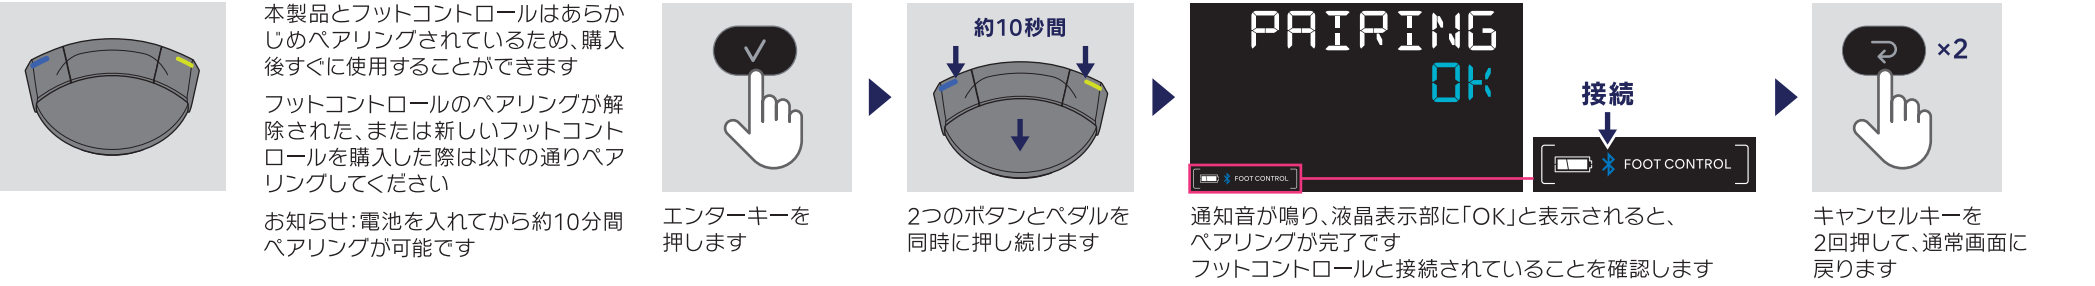

▼ Osseo 100+



▼ VarioSurg3



▼ 外部端末



www.nsk-dental.com/qr/app-surgicpro2